


精度検査表


令和 3年 3月 2日
計測者 T K S 糸井

メーカー	マキノ	型式	GF-6 no640	年式	2004, 2
------	-----	----	------------	----	---------

振り回し (300 mmピッチ)

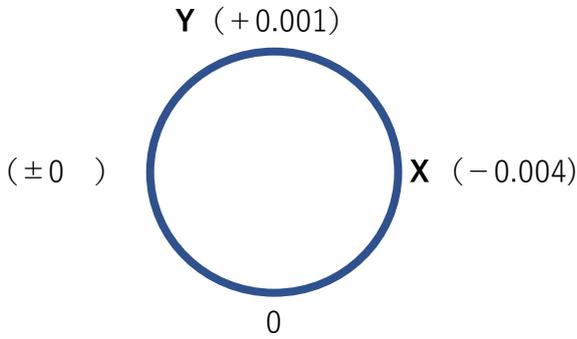

主軸振れ (300mm)

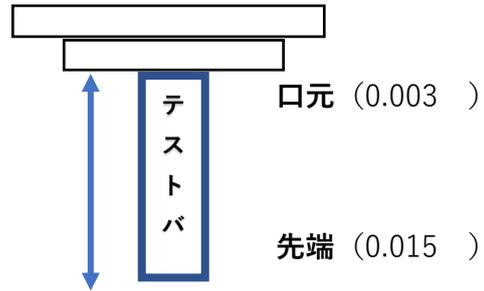


テーブル上面精度 テーブルサイズ(600mmX1400mm)


(+0.002)	(-0.007)	(±0)
(+0.008)	(±0)	(+0.003)
(+0.006)	(+0.008)	(+0.013)

直角精度 (スコヤ300mm)


X - Z

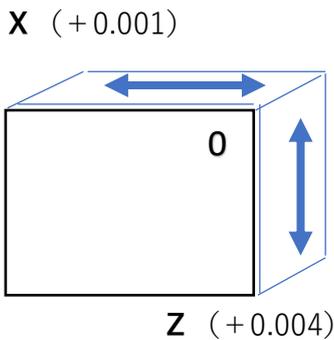

Y - Z

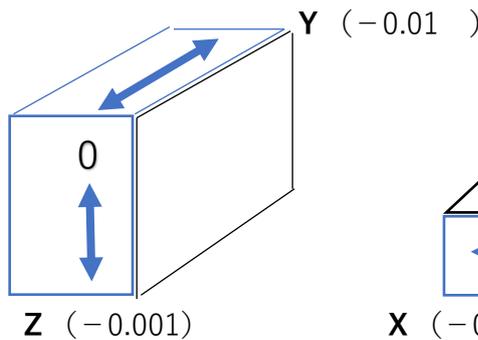

X - Y

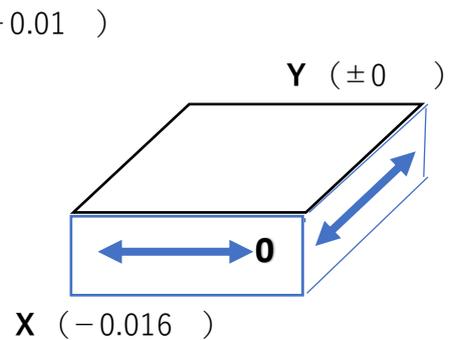

注) 精度は保証するものではありません。参考値となります。