

# 精度検査表



令和 3年 2月 3日  
測者 T K S 糸井

計

メーカー	OKK	型式	DC400	年式	2014
------	-----	----	-------	----	------

振り回し( 300 mmピッチ)

主軸振れ ( mm)

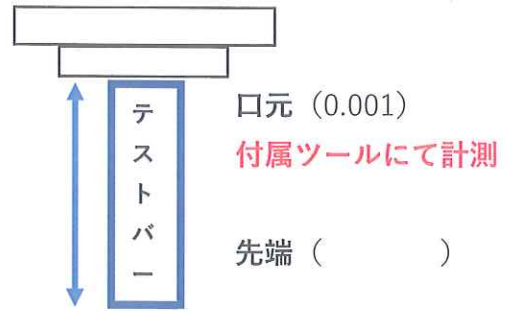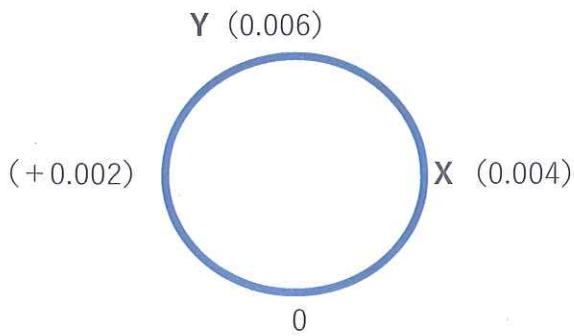


## テーブル上面精度

テーブルサイズ (800mm x 410mm)


(+0.014)	(+0.004)	(-0.003)
(+0.011)	0	(+0.005)
(+0.009)	0	(-0.003 )

## 直角度 (スコヤ300mm)


X - Z

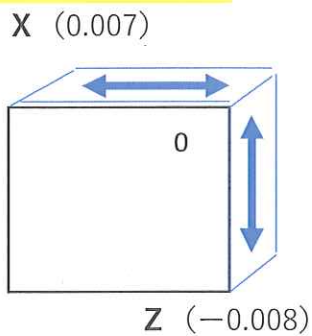

Y - Z

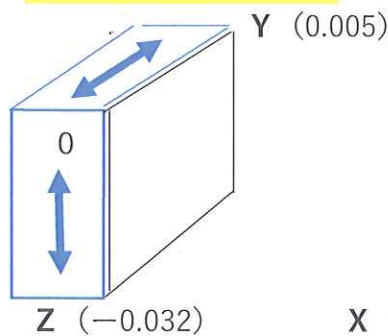

X - Y

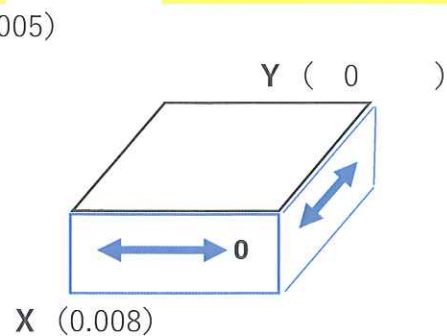

注) 精度は保証するものではありません。参考値となります。